


Guía de estratificación del riesgo del paciente y del procedimiento, con base en evidencia clínica

Todos los pacientes quirúrgicos pueden beneficiarse de la Terapia 3M™ Prevena™, pero los pacientes con alto riesgo de complicaciones, como infección del sitio quirúrgico (ISQ), pueden obtener un beneficio adicional. A continuación, se muestran datos de estudios seleccionados¹⁻³ para brindar una guía ilustrativa para ayudar en la estratificación del riesgo. Esta no es una lista exhaustiva de todos los factores de riesgo. Se recomienda a los profesionales de la salud usar su juicio clínico para identificar a pacientes o procedimientos de alto riesgo.

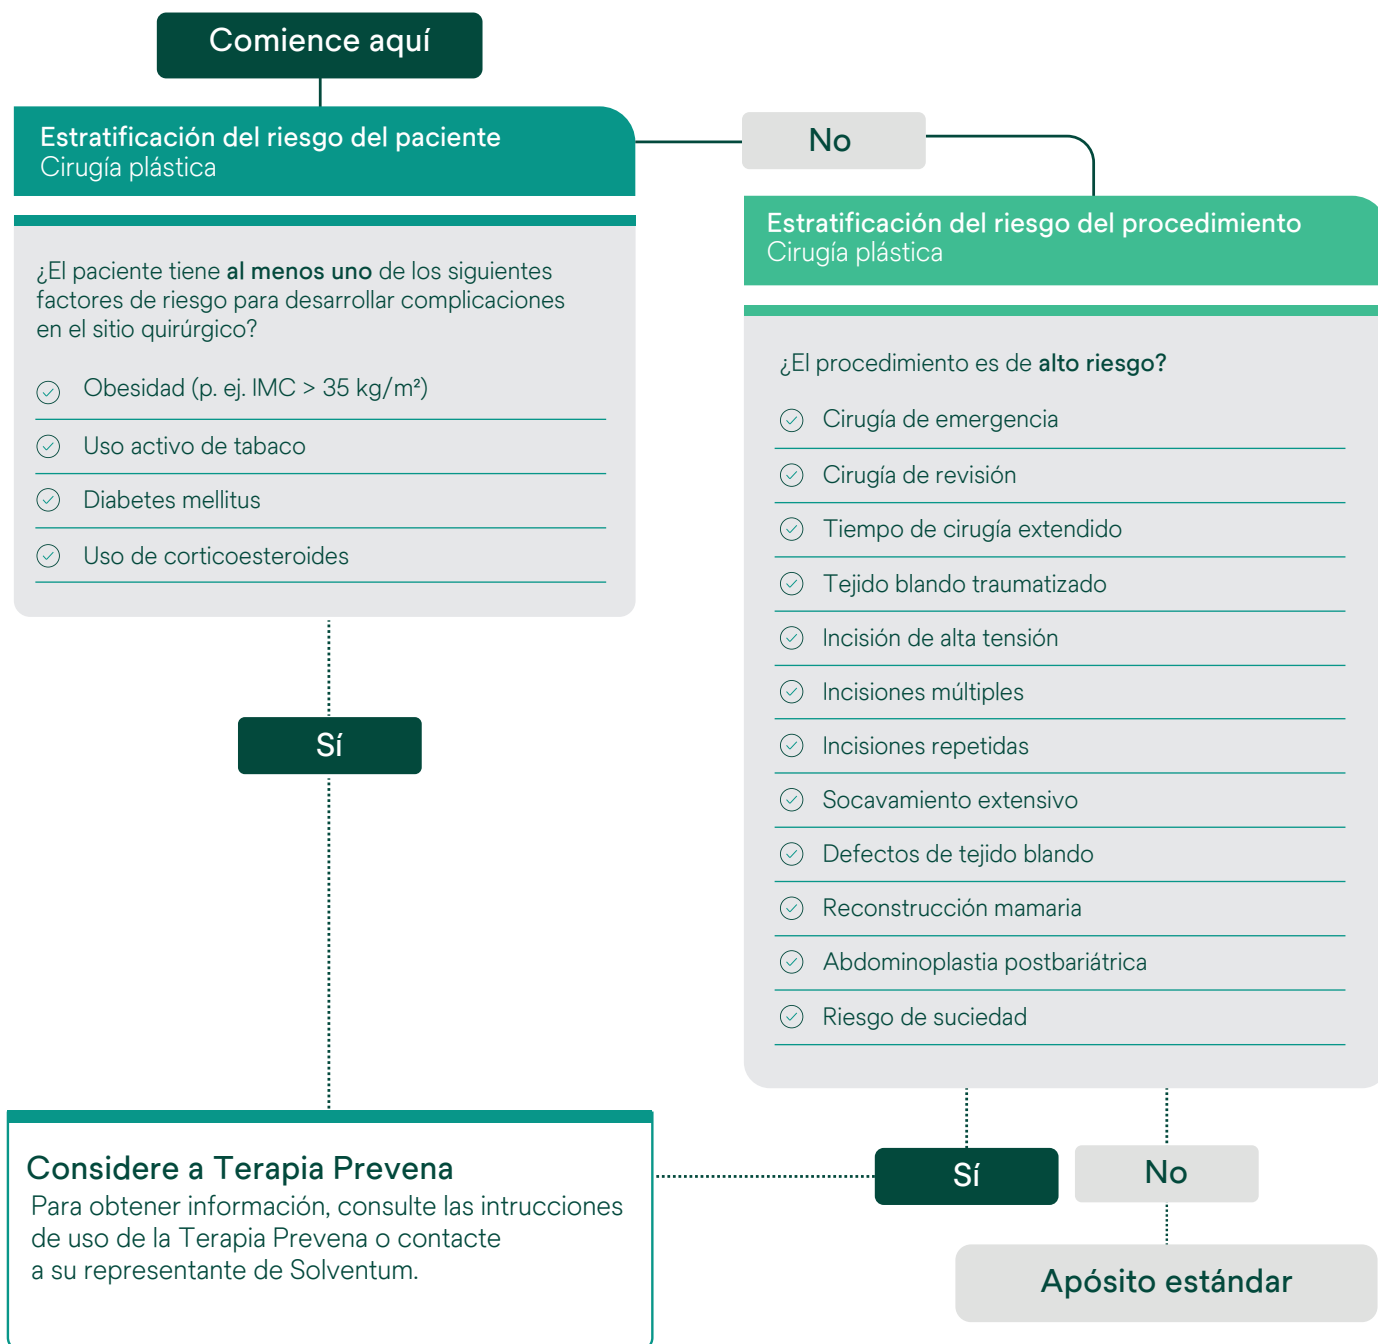


Elevando la práctica clínica

Las Unidades de Terapia 3M™ Prevena™ 125 y 3M™ Prevena™ Plus 125 gestionan el entorno de las incisiones quirúrgicas cerradas y eliminan el líquido de la incisión quirúrgica mediante la aplicación de una presión negativa continua de -125 mmHg. Cuando se utilizan con apósitos compatibles legalmente comercializados, las Unidades de Terapia Prevena 125 y Prevena Plus 125 están diseñadas para ayudar a reducir la incidencia de seroma y, en pacientes con alto riesgo de infecciones postoperatorias, ayudar a reducir la incidencia de infección superficial del sitio quirúrgico en heridas de Clase I y Clase II.

La eficacia de la Terapia Prevena para reducir la incidencia de ISQ y seromas en todos los procedimientos quirúrgicos y poblaciones no se ha demostrado. Consulte las indicaciones de uso completas y las limitaciones en HCBGRegulatory.3m.com.

La indicación de la FDA de reducir la incidencia de seromas e infecciones superficiales del sitio quirúrgico en heridas Clase I y II, sólo aplica a las Unidades de Terapia Prevena 125 y Prevena Plus 125 (7 días). La indicación no se aplica a la Unidad de Terapia Prevena Plus 125 (14 días) que se suministra con los kits 3M™ Prevena Restor™ o los apósitos 3M™ Prevena Restor™ (consulte las Instrucciones de uso del sistema Prevena Restor).



Descargue el compendio clínico de Terapia de Presión Negativa Incisional Cerrada y acceda a la evidencia clínica de la Terapia Prevena de cirugía plástica

Referencias:

1. Willy C, Agarwal A, Andersen CA, De Santis G, Gabriel A, Grauhan O, Guerra OM, Lipsky BA, Malas MB, Mathiesen LL, Singh DP, Reddy VS. Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. *Int Wound J*. 2017 Apr;14(2):385-398.
2. Higuera-Rueda CA, Emara AK, Nieves-Malloure Y, Klika AK, Cooper HJ, Cross MB, Guild GN, Nam D, Nett MP, Scuderi GR, Cushner FD, Piuze NS, Silverman RP. The Effectiveness of Closed-Incision Negative-Pressure Therapy Versus Silver-Impregnated Dressings in Mitigating Surgical Site Complications in High-Risk Patients After Revision Knee Arthroplasty: The PROMISES Randomized Controlled Trial. *J Arthroplasty*. 2021 Jul;36(7S):S295-S302.e14. Note that the length of therapy may be outside the range recommended in the Instructions for Use.
3. Newman JM, Siqueira MBP, Klika AK, Molloy RM, Barsoum WK, Higuera CA. Use of Closed Incisional Negative Pressure Wound Therapy After Revision Total Hip and Knee Arthroplasty in Patients at High Risk for Infection: A Prospective, Randomized Clinical Trial. *Journal of Arthroplasty*. 2019 Mar;34(3):554-559. Note that the length of therapy may be outside the range recommended in the Instructions for Use.

NOTA: Existen indicaciones específicas, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información de seguridad para estos productos y terapias. Consulte a un profesional de la salud y las instrucciones del producto antes de la aplicación. Solo con receta médica.



Solventum Medical Surgical
Los Militares 4611 P.12, Las Condes, Santiago - Chile.
productos.cl@solventum.com
800 914 850

**Para obtener más información,
visite www.solventum.com/es-cl**

© Solventum 2025. Solventum, el logotipo S y Prevena son marcas comerciales de Solventum o sus filiales. 3M y el logotipo de 3M son marcas registradas de 3M. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.